

1 Dr. \_\_\_\_\_ (name) Acc./PO no.: \_\_\_\_\_  
Codigo postal: \_\_\_\_\_ Movil: \_\_\_\_\_

2 \*Sin datos personales del paciente\*  
Tu referencia de caso: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_ Iniciales: \_\_\_\_ / \_\_\_\_

3 **Especificar:** **Prótesis de acrílico**  **Estructura metálica**  **Flexite** FAVOR SELECCIONAR

4 **Etapa** Siempre danos **10 días hábiles completos** **Fecha de Entrega**

**Mordida** (2 días hábiles) U / L Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Bandeja Especial** U / L Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Prueba** (4 días hábiles) U / L Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Terminación** (4 días hábiles) U / L Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

o: Terminado **en una** sola sesión U / L Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

## DENTADURA O ESTRUCTURA

*Solo para uso en laboratorio, aplicación real.*

- ..... @ .....

- ..... @ .....

- ..... @ .....

*Solo para uso en laboratorio, abierto por:*

1	2
4	3

5 **Tono** - utilizar la guía VITA Favor seleccionar)

6 **Instrucciones**

Coronas telescópicas en: \_\_\_\_\_

Ataches especial en: \_\_\_\_\_

Dientes en prótesis dental inmediata: \_\_\_\_\_ →  @ prueba de ajuste


**POR FAVOR, indíquenos si se extraerán las raíces y en qué etapa.** →  @ acabado

Hacer ganchos en: \_\_\_\_\_

*Solo para uso en laboratorio, adjunto / faltante:*

He desinfectado la impresión con: \_\_\_\_\_  
por: \_\_\_\_\_

# Sólo PRIVADO

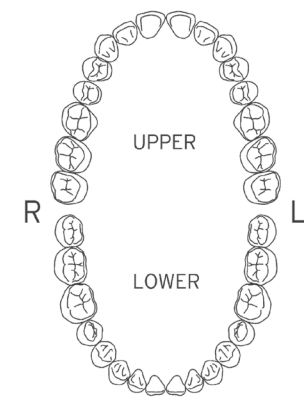

Devolver mediante envío especial mínimo € 5

Este caso es un caso para rehacer

He adjuntado los siguientes componentes nuevos o antiguos \_\_\_\_\_

**Dispositivo hecho a medida | Suministrado en un estado no esterilizado | Se aplican términos y condiciones | Visita [www.medimatch.es](http://www.medimatch.es)**

**Información sobre el aparato dental y nota de entrega:** Producto dental diseñado para satisfacer la información, propiedades y detalles prescritos por el dentista mencionado anteriormente. Únicamente para el uso del paciente descrito con la referencia anterior. El producto cumple con los requisitos establecidos en el Anexo I y el Anexo VIII de la Directiva de Dispositivos Médicos, así como con la Ley de Regulación de Dispositivos Médicos de la República de Irlanda, SI 252/1994. Este producto puede haber sido fabricado en España, Reino Unido o China por MediMatch. **Instrucciones de uso, almacenamiento y manejo:** Se recomienda encarecidamente que el producto se almacene en un entorno limpio y seguro si no se va a usar inmediatamente. También se aconseja que no haya contacto con materiales, líquidos o ácidos que puedan causar deformaciones o daños al producto. El producto no debe estar expuesto a calor extremo. Si es aplicable, debes tener cuidado de no dañar la(s) pieza(s) dental al retirarla(s) de su modelo. ESTE APARATO DENTAL SE SUMINISTRA EN UN ESTADO NO ESTERILIZADO